

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PODAIS



Cunha de Calcâneo (CC)



Espessuras (mm)

1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0

Aplicação

Retropé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Correção articular subtalar
(Anti-varo e Anti-valgo)



Cunha de Calcâneo em Resina (CC)



Espessuras (mm)

1,0

Aplicação

Retropé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Correção articular subtalar
(Anti-varo e Anti-valgo)



Realce de Calcâneo (RC)

Espessuras (mm)

1,5 | 2,0 | 2,5

Aplicação

Retropé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Correção da articular subtalar (Anti-varo e Anti-valgo)

Estabilização do calcânhar (aplicação bilateral) Ex.: RC+RC



Realce de Calcâneo em Resina (RC)



Espessuras (mm)

1,5 | 2,0 | 2,5

Aplicação

Retropé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Correção da articular subtalar (Anti-varo e Anti-valgo)

Estabilização do calcânhar (aplicação bilateral) Ex.: RC+RC



Barra de Calcâneo (BC)

Espessura (mm)

2,0

Aplicação



Retropé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Em pé plano, tensionamento da
musc. Flexora Plantar

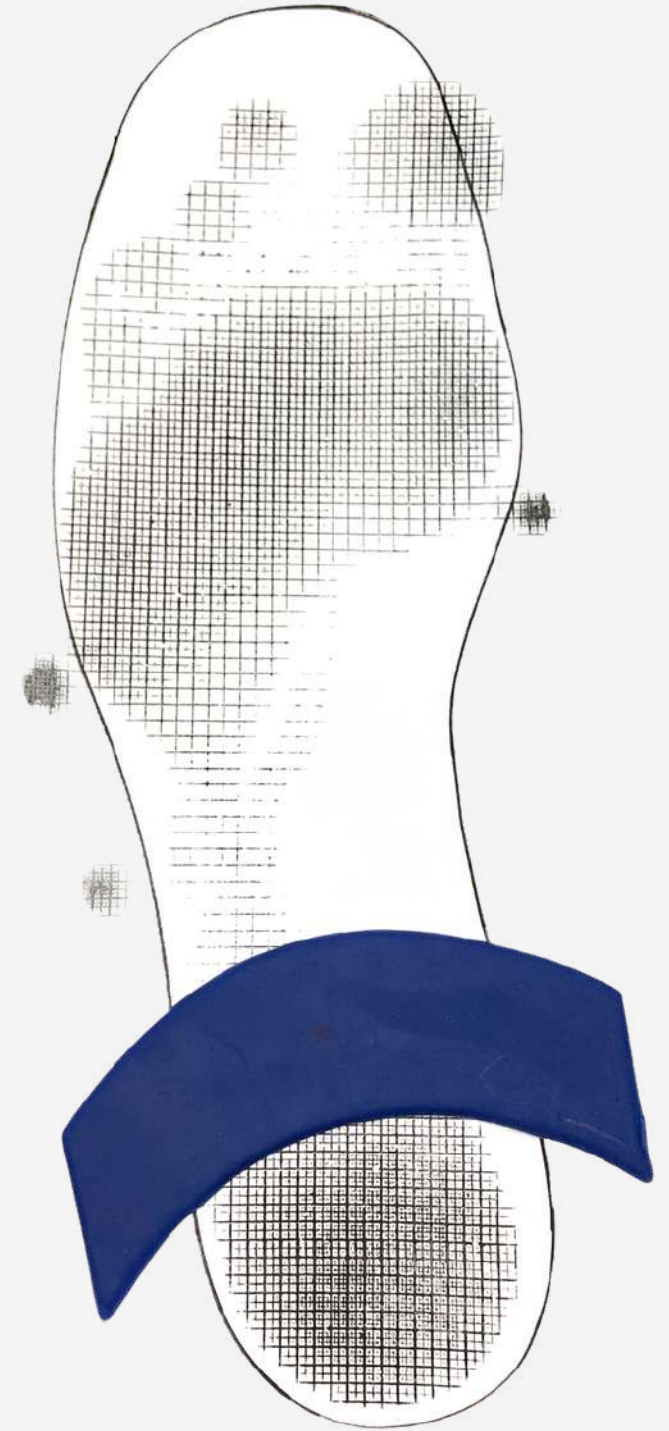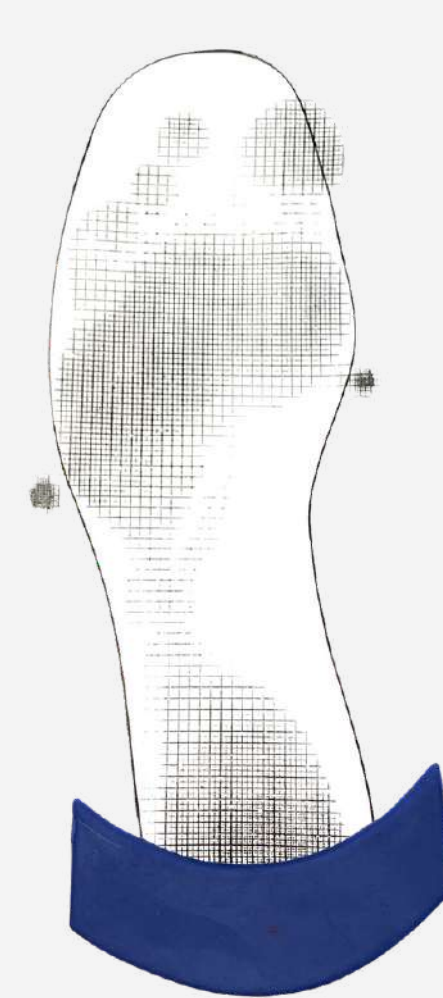

Cunha Base (CB)

Espessura (mm)

12

Aplicação

Retropé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Discrepâncias acima de 1.2cm (12mm)
Correção da articulação subtalar
(Anti-varo e Anti-valgo)
Nivelamento da Pelve



Estabilizador de Calcâneo (EC)


Espessura (mm)

VARIADA

Aplicação

Retropé

Durometro

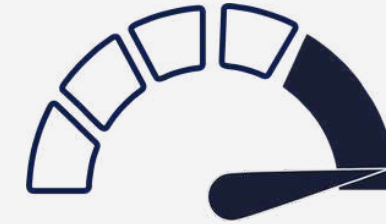

INDICAÇÃO PODAL

Entorses repetitivos
Utilização em pacientes idosos
Estabilização do calcanhar

Indicação Postural



Estabilizador de Calcâneo em Resina (EC)



Espessura (mm)

1,0

Aplicação

Retropé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Entorses repetitivos
Utilização em pacientes idosos
Estabilização do calcanhar

Indicação Postural



Estabilizador de Calcâneo Zero Impact (EC ZI)




Espessura (mm)

3

Aplicação

Retropé

Durometro

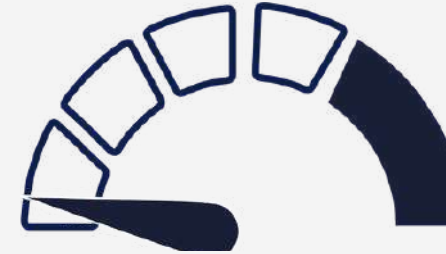

INDICAÇÃO PODAL

Entorses repetitivos
Utilização em pacientes idosos
Estabilização do calcânhar
Pés Diabéticos



Hemicúpula Postural (HCP)



Espessuras (mm)

3,0 | 3,5 | 5,0

Aplicação


Mediopé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Arco desabado

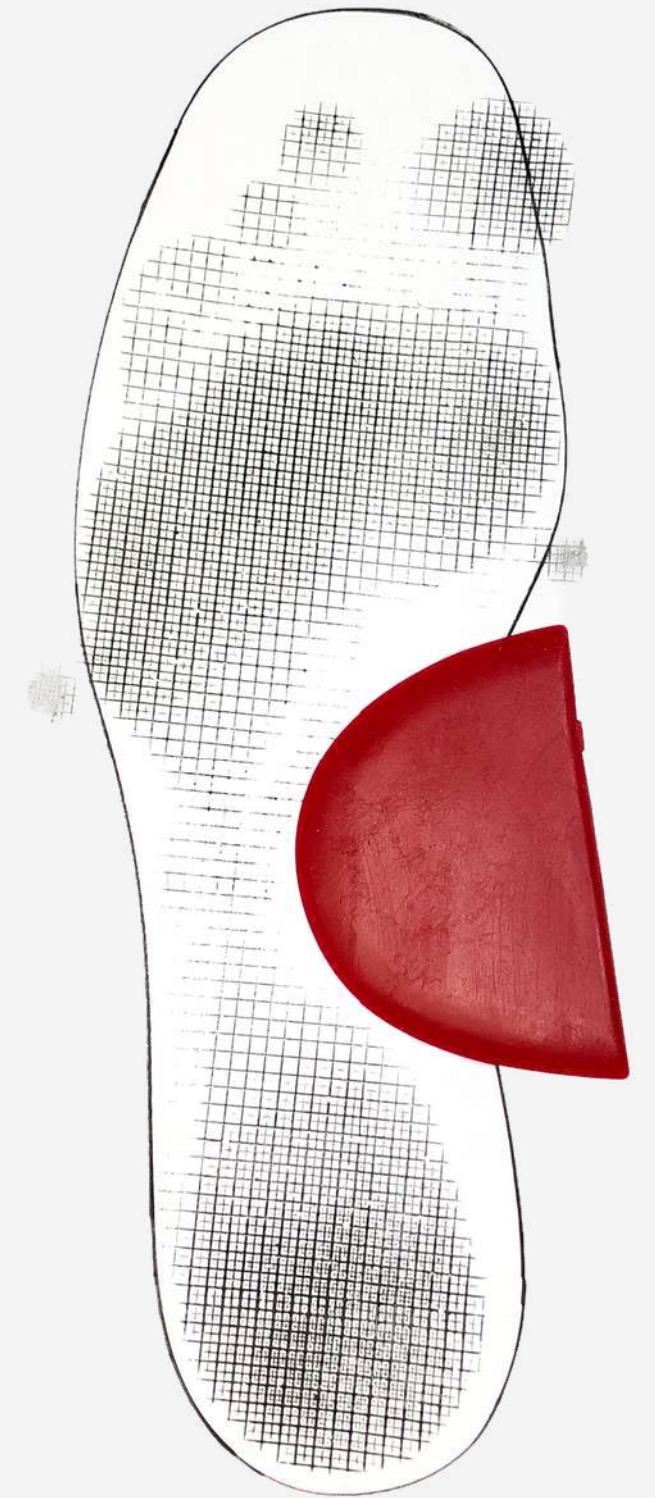

Suporte de Arco Longitudinal (SPA)


Espessuras (mm)

12

Aplicação

Mediopé

Durometro

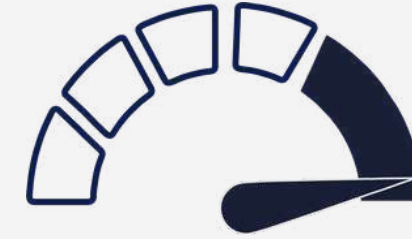

INDICAÇÃO PODAL


Pé plano com arco desabado.

CARACTERISTICAS

P:34-38

G: 39-46

Dura

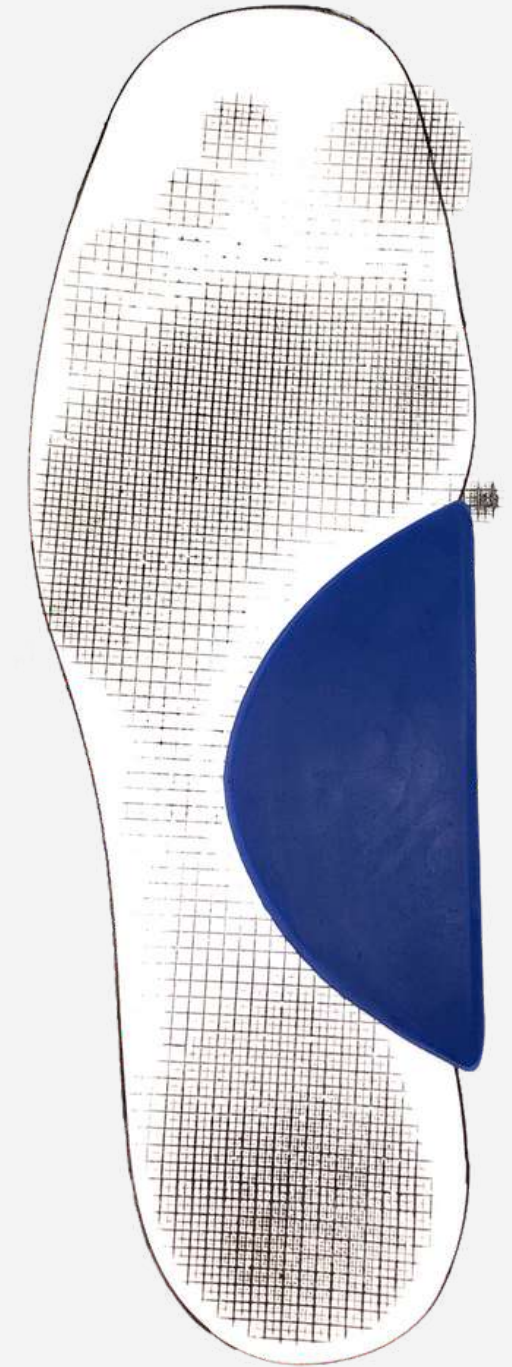

Suporte de Arco Longitudinal (SPA)


Espessuras (mm)

12

Aplicação

Mediopé

Durometro

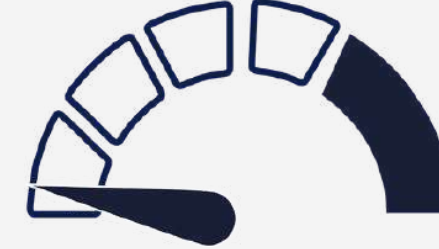

INDICAÇÃO PODAL


Pé plano com arco desabado.

CARACTERISTICAS

P:34-38

G: 39-46

Macia

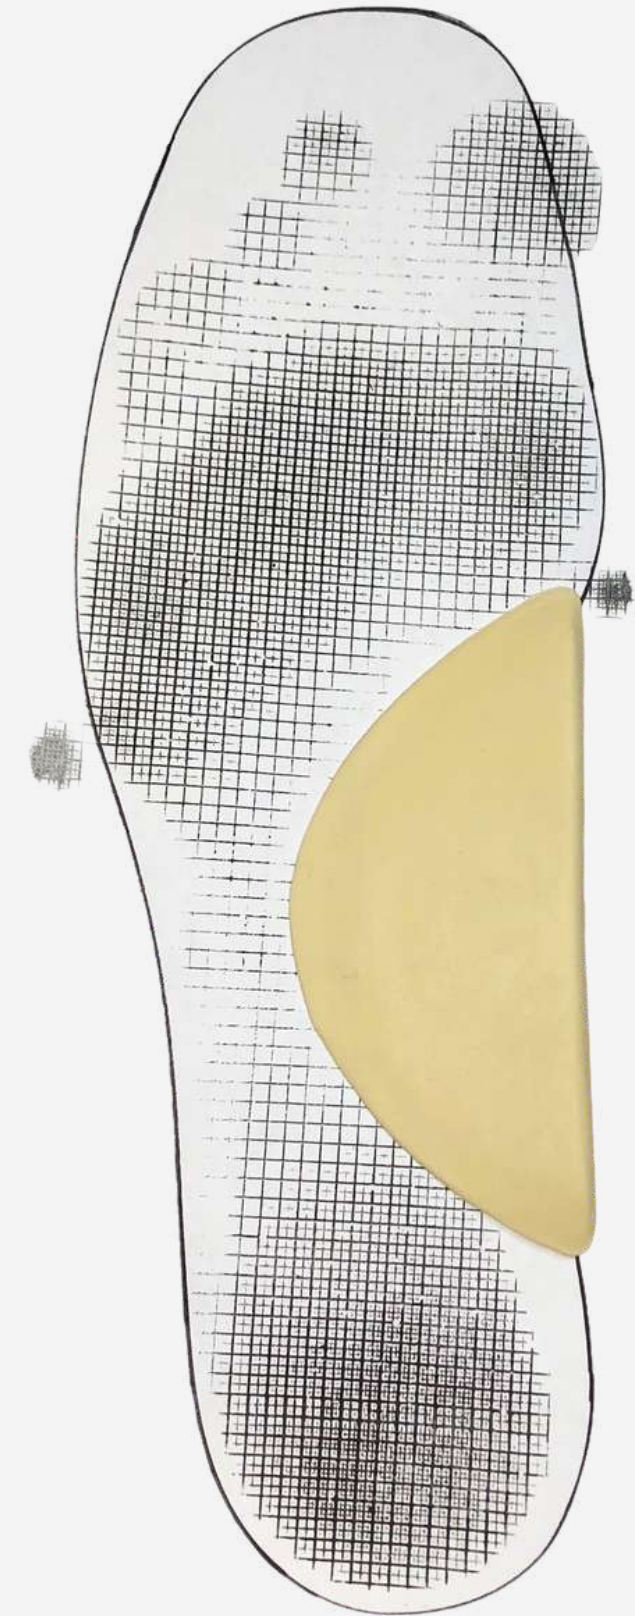

Suporte de Arco Elevado (SAE)


Espessuras (mm)

1~30

Aplicação

Mediopé

Durometro

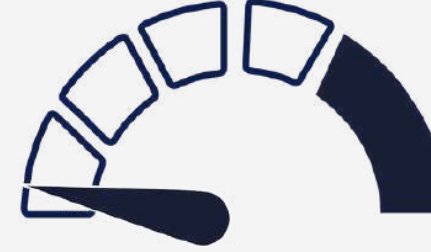

INDICAÇÃO PODAL

Pé plano com arco desabado.

CARACTERISTICAS

P: 34-38

G: 39-46



Suporte de Arco Transverso (SAT)

Espessuras (mm)

P:3,0 G:5,0

Aplicação

Mediopé

Durometro




INDICAÇÃO PODAL

Metatarsalgia
Neuroma de Mórton
Fascite Plantar

CARACTERISTICAS

P: 33-37
G: 38-46.

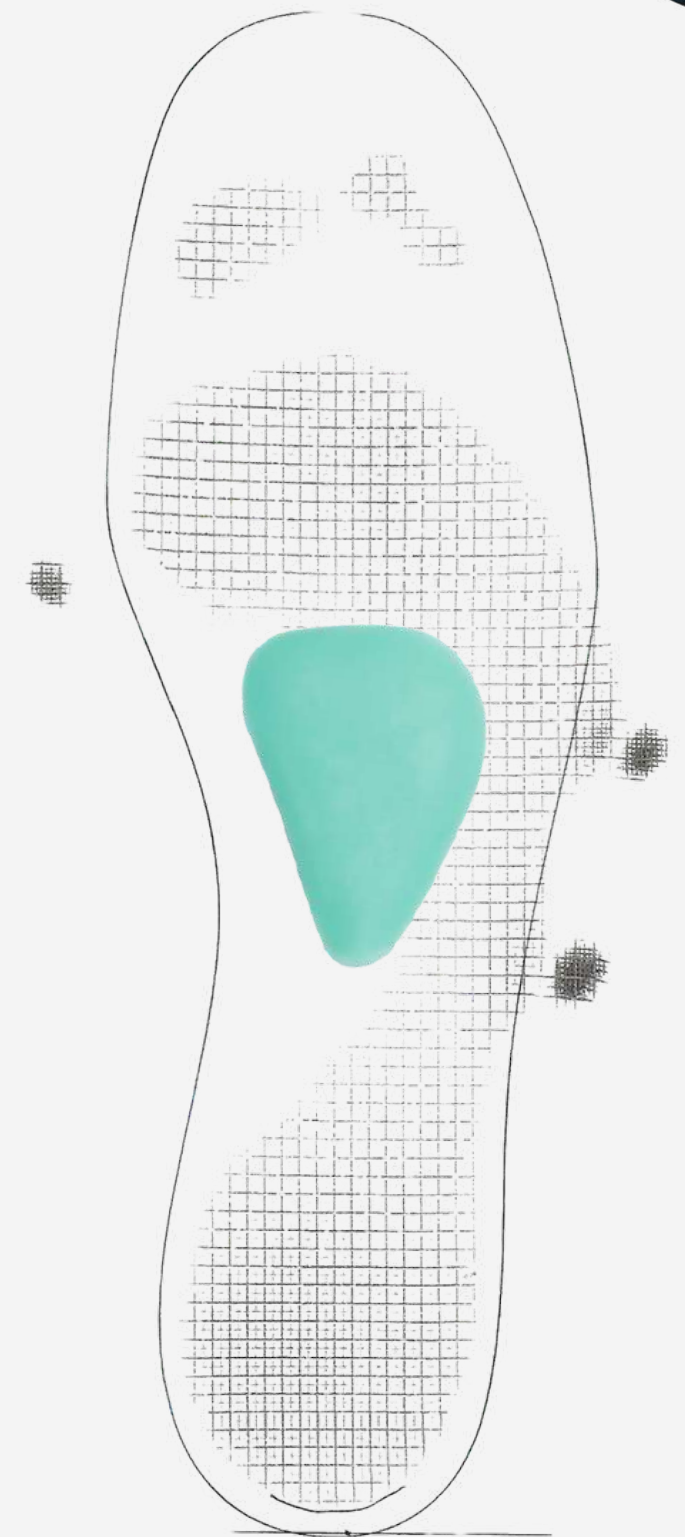

Consultoria Exclusiva

Suporte de Arco Transverso em Resina (SAT)




Espessuras (mm)

1,0

Aplicação

Mediopé

Durometro

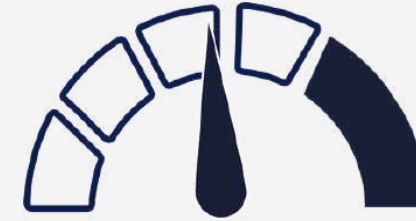

INDICAÇÃO PODAL

Metatarsalgia
Neuroma de Mórton
Fascite Plantar


CARACTERÍSTICAS

P: 33-37

G: 38-46.



Consultoria Exclusiva

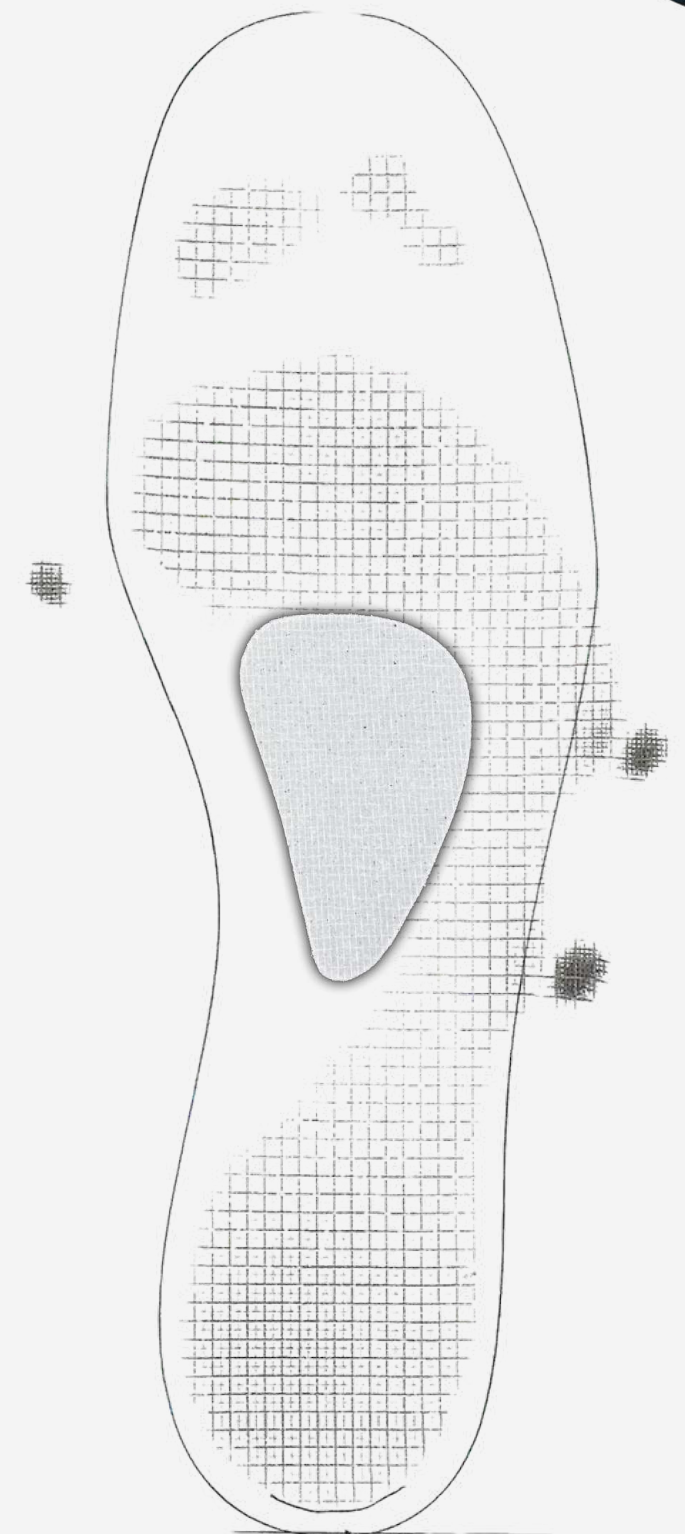

Suporte de Arco Transverso Zero Impact (SAT ZI)




Espessuras (mm)

3,0

Aplicação

Mediopé

Durometro


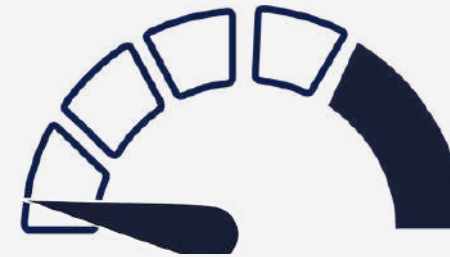


INDICAÇÃO PODAL

Metatarsalgia
Neuroma de Mórton
Fascite Plantar

CARACTERÍSTICAS

P: 33-37
G: 38-46.

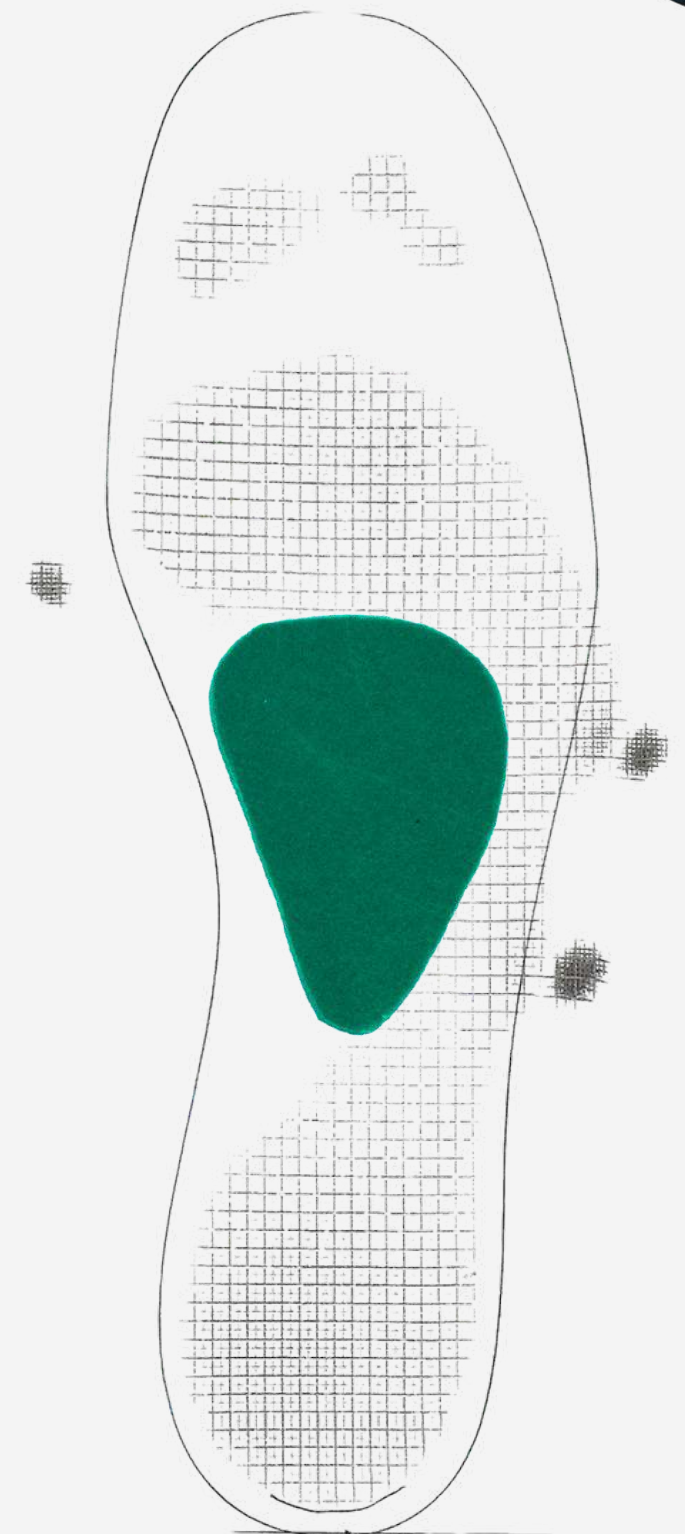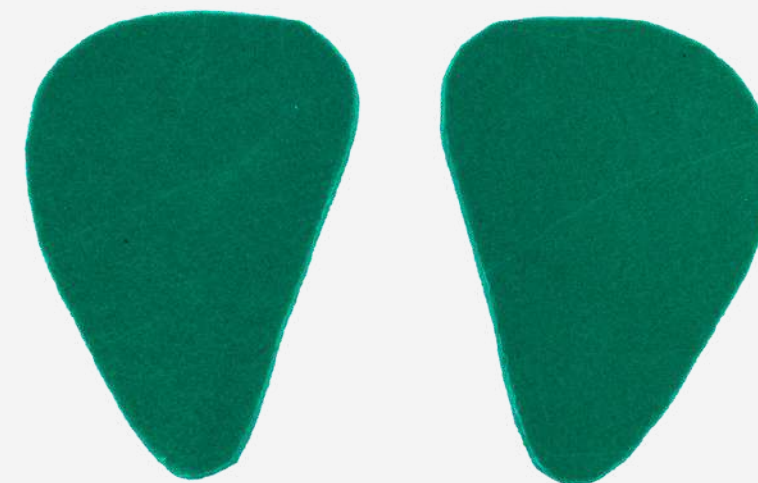

Consultoria Exclusiva

Barra Retocapital Prolongada (BRCP)




Espessuras (mm)

3,5

Aplicação

Mediopé

Durometro

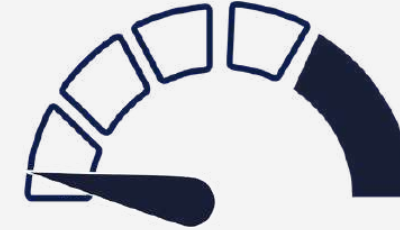

INDICAÇÃO PODAL

Metatarsalgia, Fascite Plantar,
relaxamento da flexora plantar.

CARACTERÍSTICAS

Lateralidade



Botão Infracuboide (BTIC)




Espessuras (mm)

2,5

Aplicação

Mediopé

Durometro

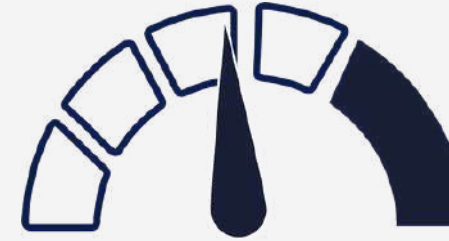


INDICAÇÃO PODAL

Anti rotator interno

Informação proprioceptiva de rotação interna durante a marcha

Fechamento de cadeia adutora

Shift Pélvico homolateral

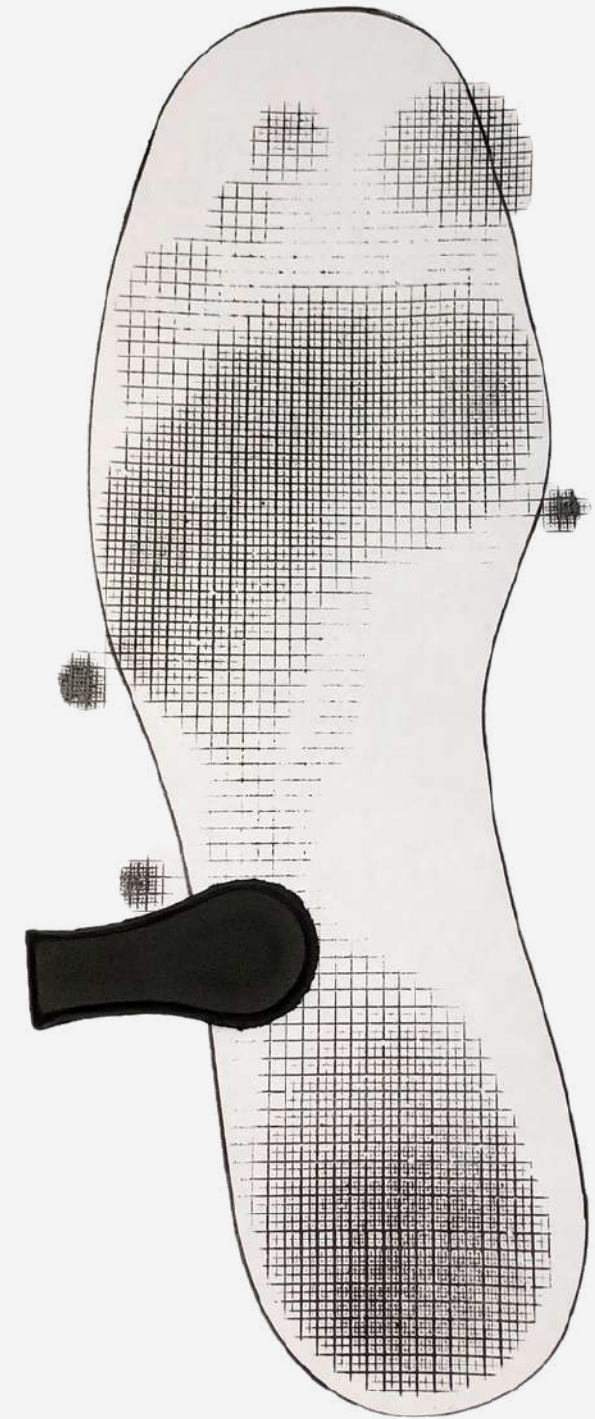

Barra Retrocapital (BRC)

Espessuras (mm)

1,5 | 2,5

Aplicação

Antepé

Durometro




INDICAÇÃO PODAL

Metatarsalgia, Fascite Plantar,
relaxamento da flexora plantar.

CARACTERISTICAS

Lateralidade

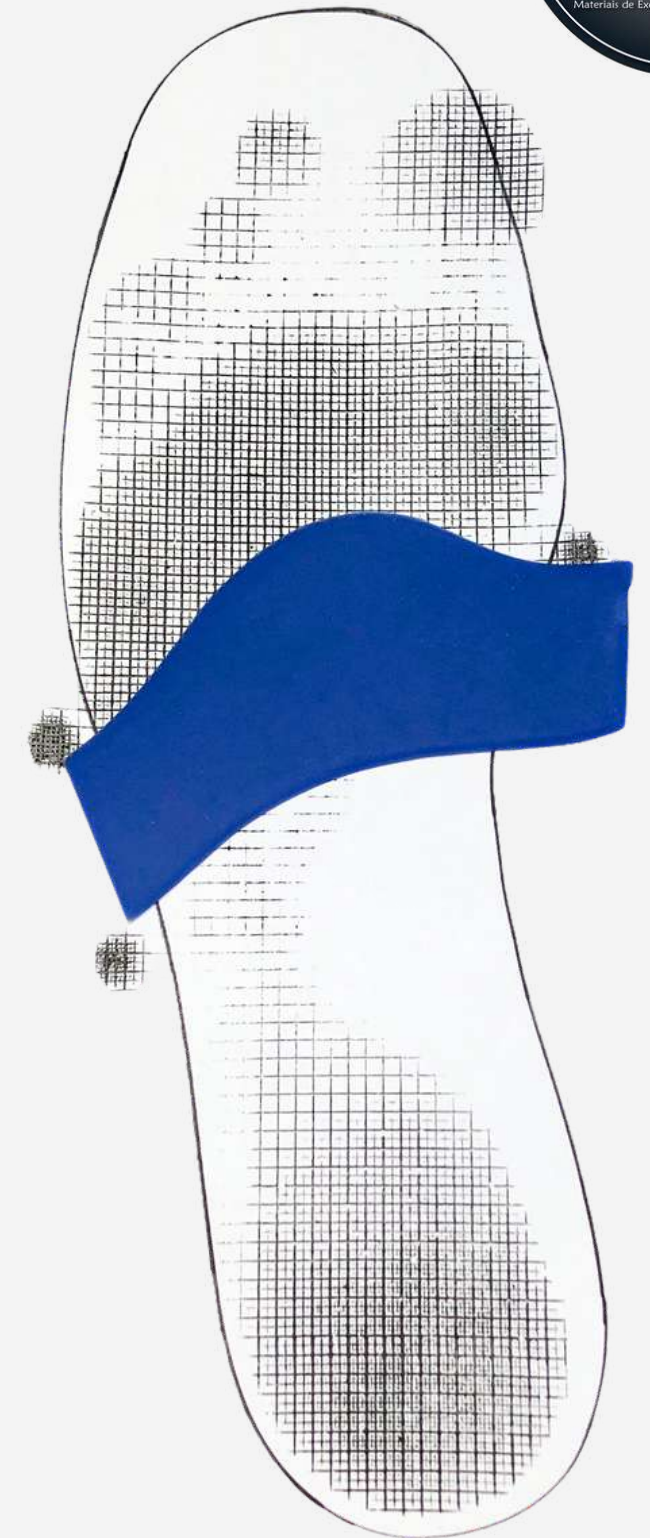

Barra Retrocapital em Resina (BRC)


Espessuras (mm)

1,0

Aplicação


Antepé

Durometro

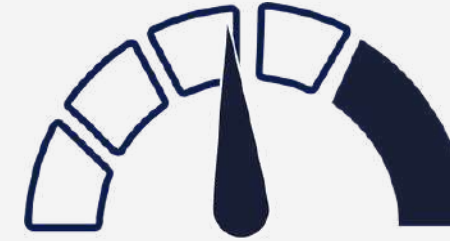

INDICAÇÃO PODAL

Metatarsalgia, Fascite Plantar,
relaxamento da flexora plantar.

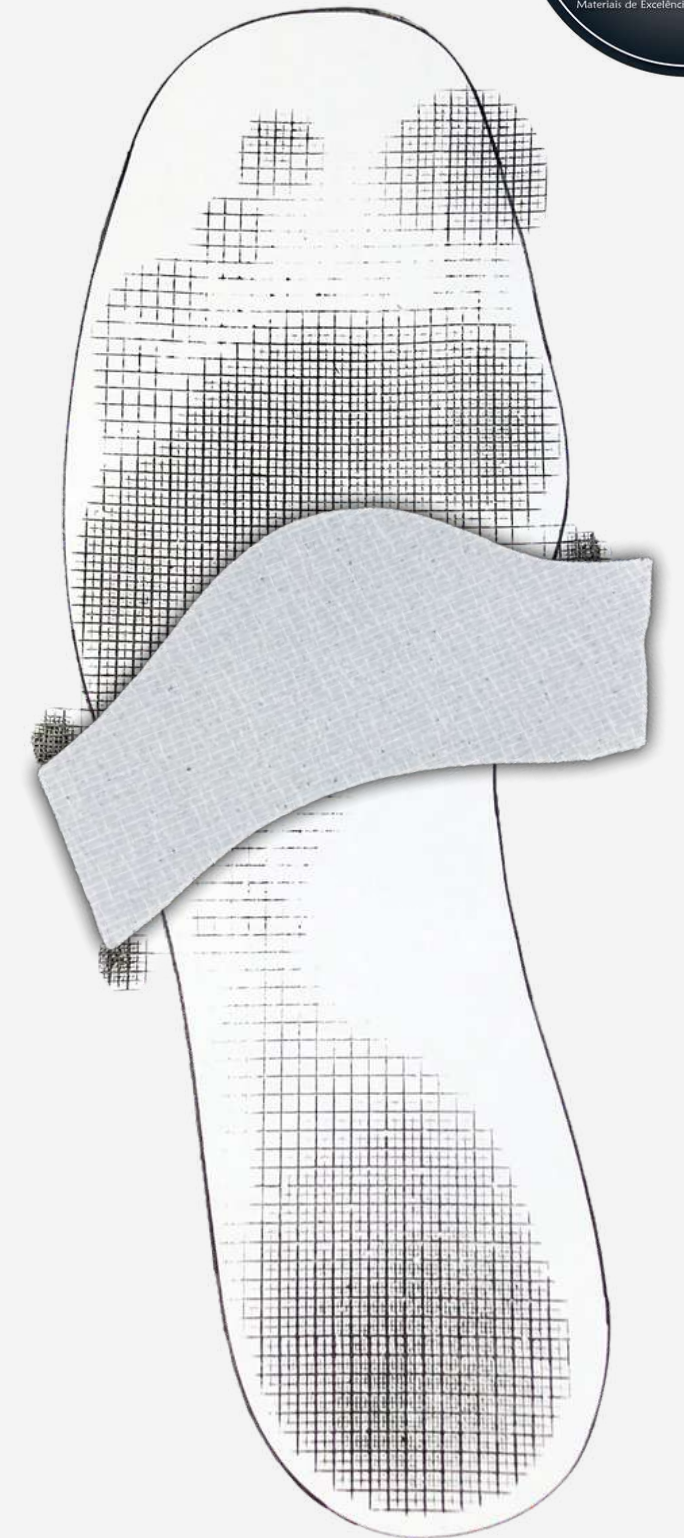

Barra Retrocapital Zero Impact (BRC ZI)




Espessuras (mm)

3,0

Aplicação


Antepé

Durometro

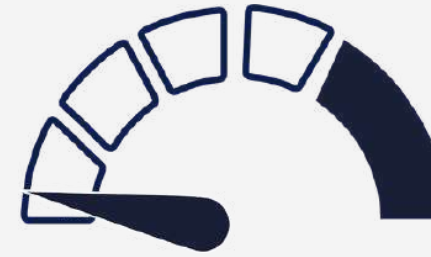

INDICAÇÃO PODAL

Metatarsalgia, Fascite Plantar,
relaxamento da flexora plantar.
Pés Diabéticos

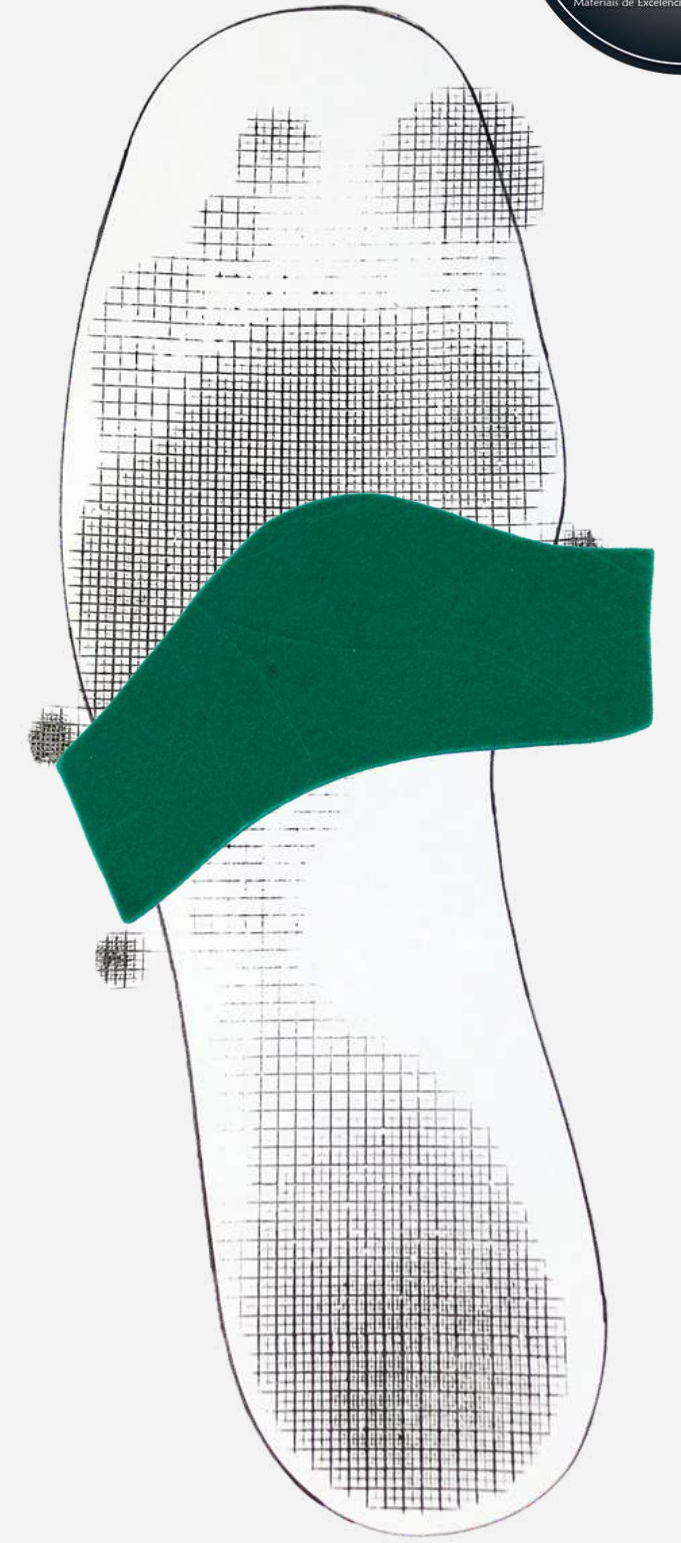

Barra Infracapital (BIC)



Espessuras (mm)

2,0

Aplicação

Antepé

Durometro




INDICAÇÃO PODAL

Hálux valgo
Nivelamento do antepé em caso de
discrepância.

CARACTERÍSTICAS

Lateralidade

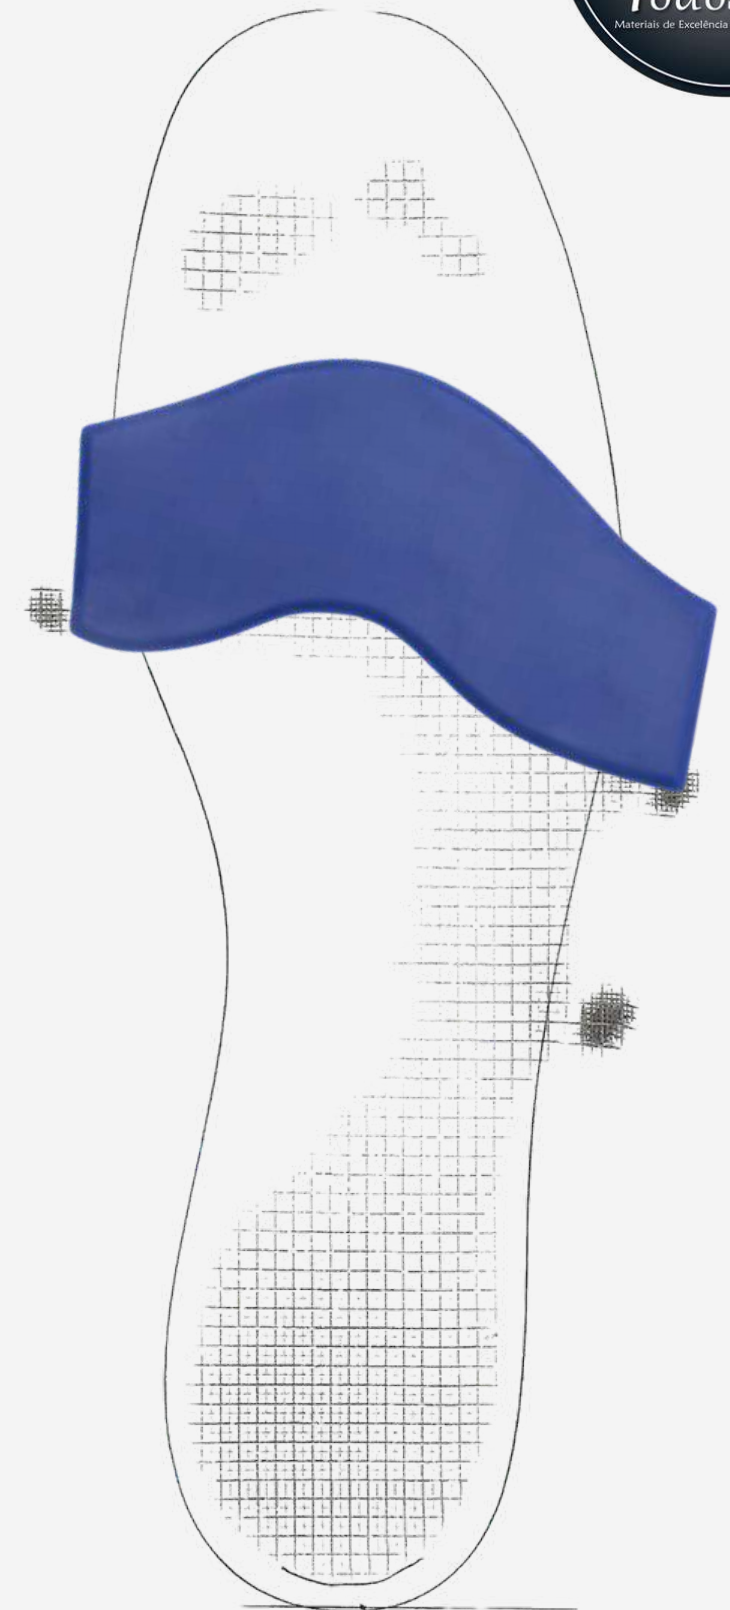

Barra Infracapital em Resina (BIC)



Espessuras (mm)

1,0

Aplicação

Antepé



Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Hálux valgo

Nivelamento do antepé em caso de discrepância.

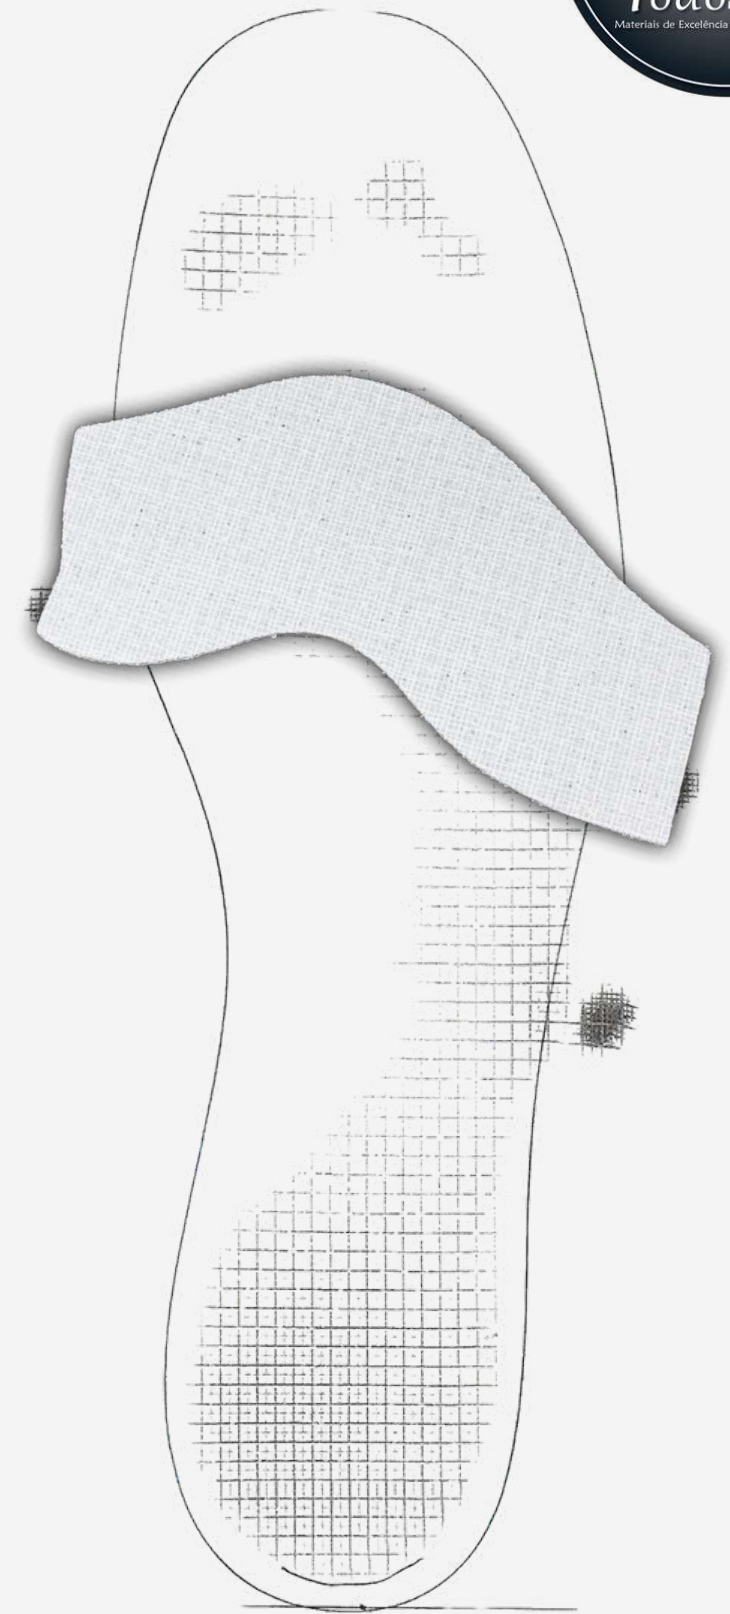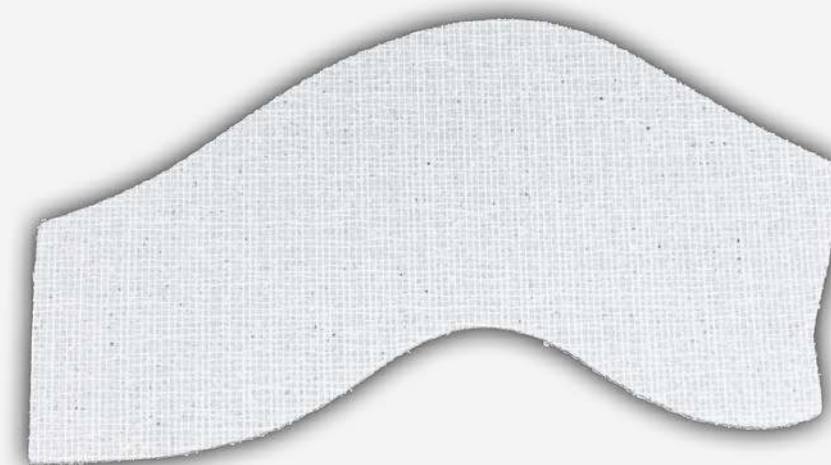

Barra Infracapital em Resina (BIC)




Espessuras (mm)

3,0

Aplicação


Antepé

Durometro

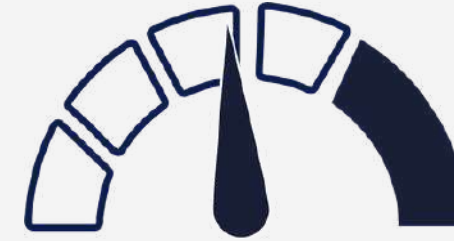

INDICAÇÃO PODAL

Hálux valgo
Nivelamento do antepé em caso de
discrepância.
Pés Diabéticos

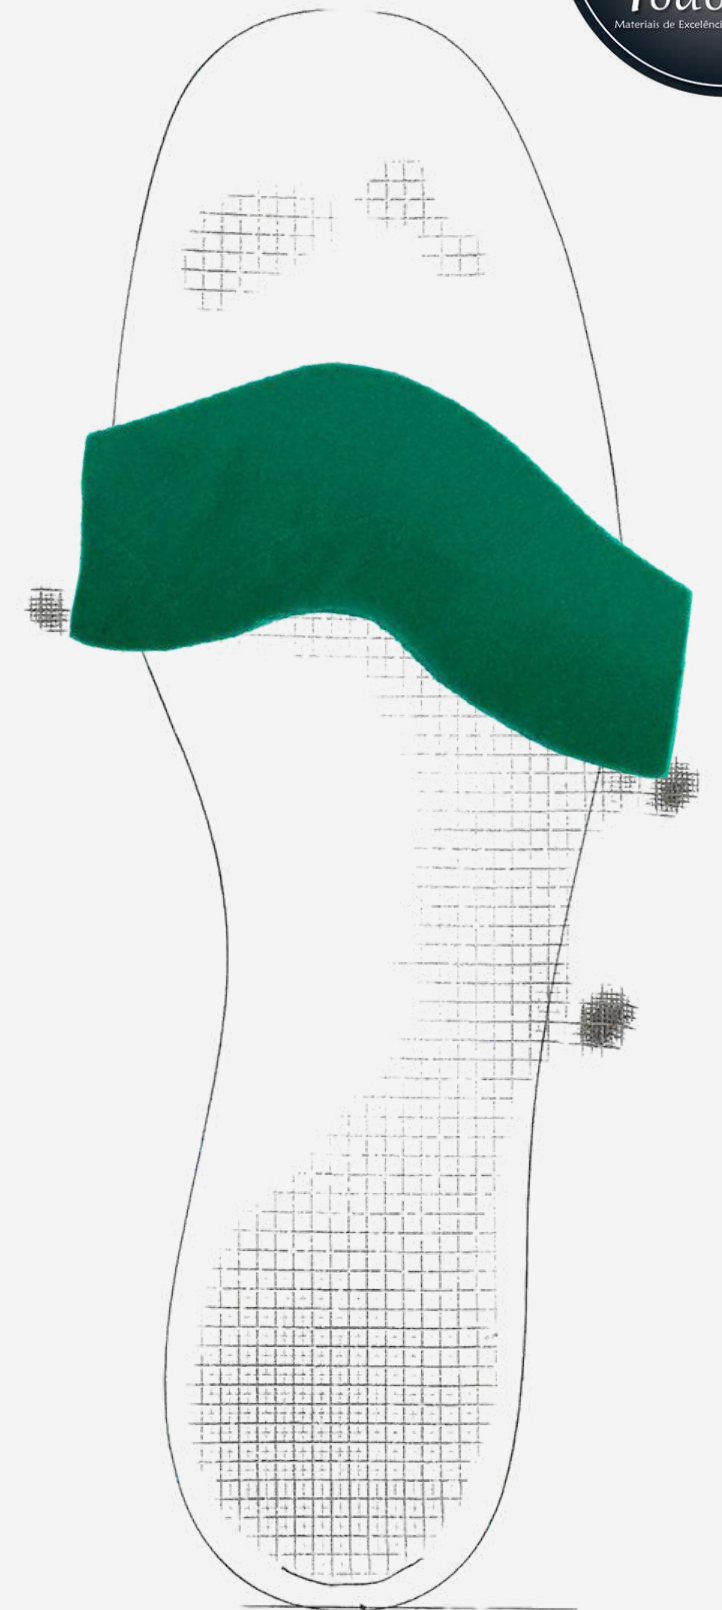

Botão Proprioceptivo (BT)

Espessuras (mm)

2,5

Aplicação


Antepé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Abdução durante a marcha. Ativação da cadeia abductora
Casos de rotação interna de marcha

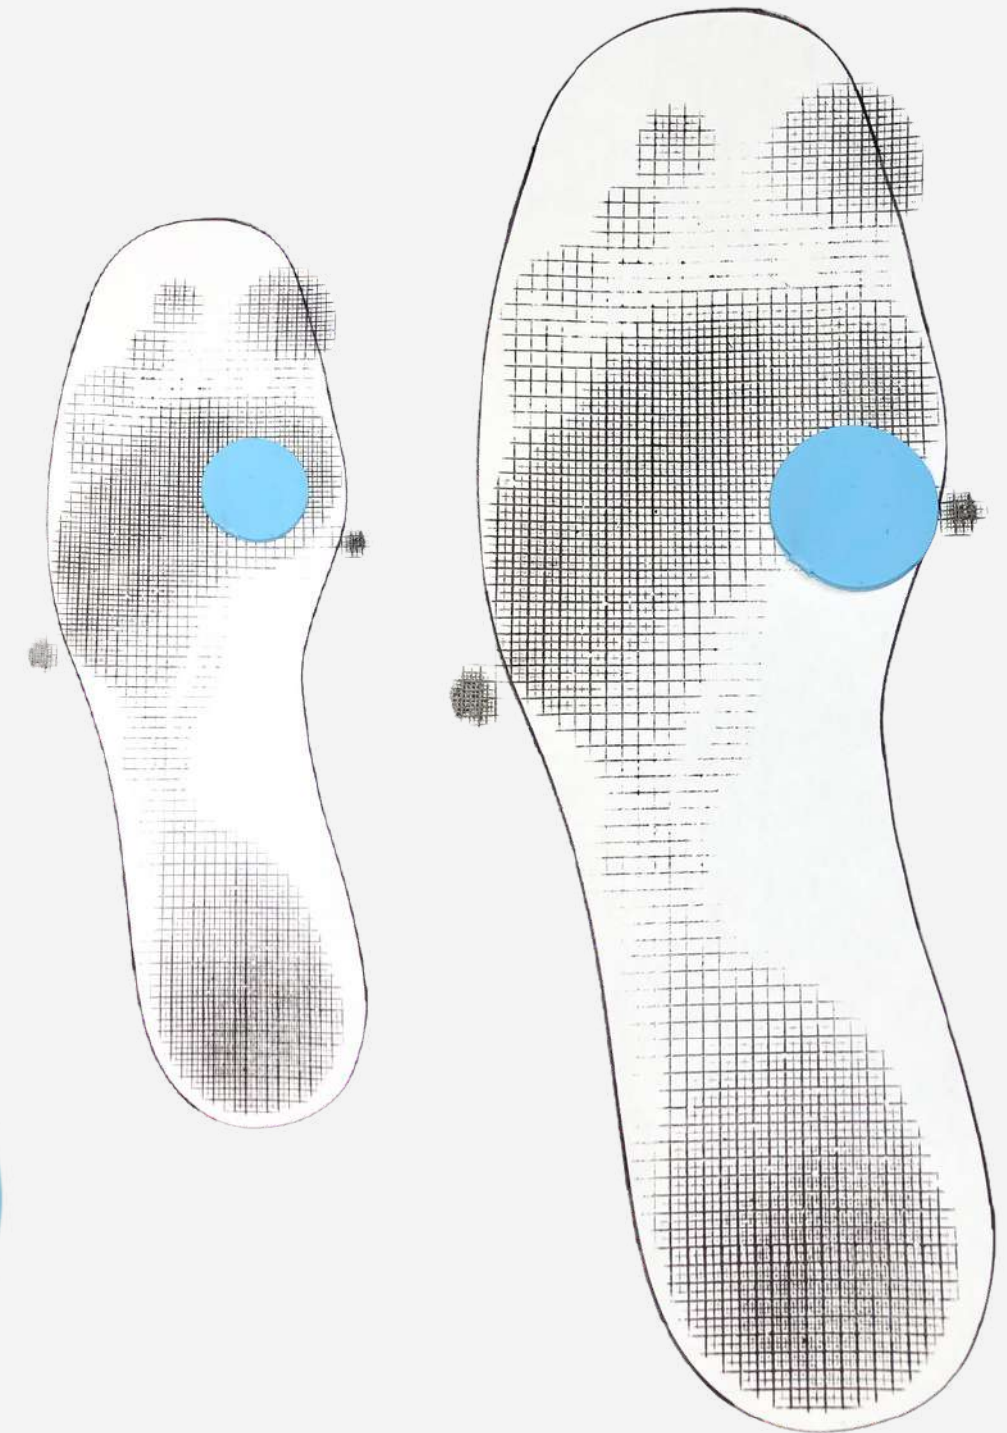

Botão Proprioceptivo em Resina (BT)



Espessuras (mm)

1,0

Aplicação

Antepé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Abdução durante a marcha. Ativação da cadeia abductora
Casos de rotação interna de marcha



Apoio Retrocapital Prolongado (ARCP)

Espessuras (mm)

VARIADA

Aplicação

Retropé - Antepé

Durometro



INDICAÇÃO PODAL

Correção pé supinado ou pronado em bloco.

Correção em bloco subtalar, mediopé e antepé (arco transversal).



Estabilizador com Arco Elevado (EAE)


Espessuras (mm)

VARIADA

Aplicação



Retropé - Mediopé

Durometro

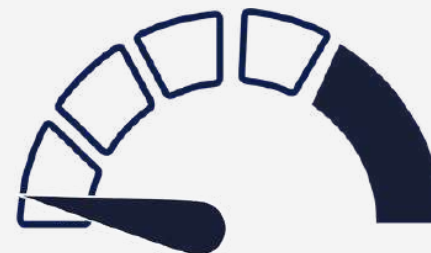

INDICAÇÃO PODAL

Estabilização da subtalar, em conjunto com a elevação do arco medial.

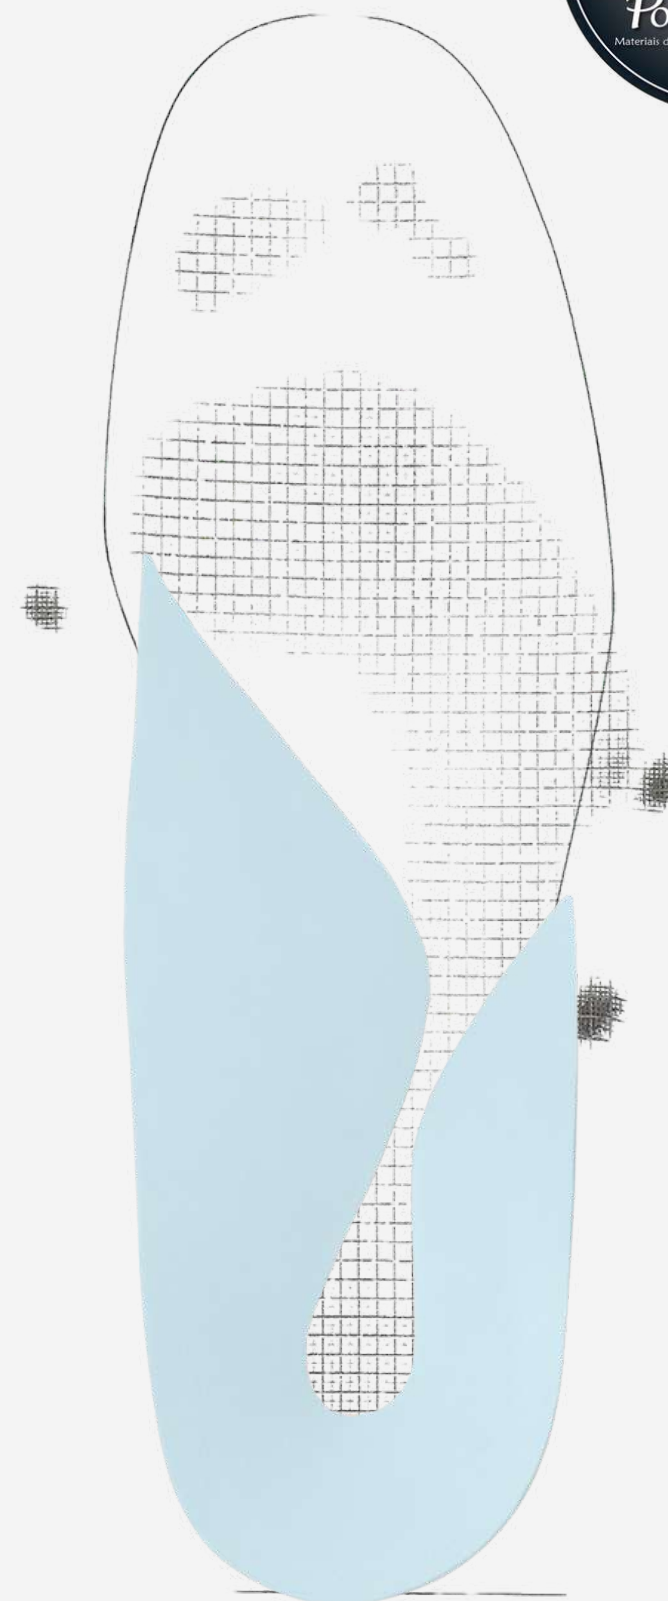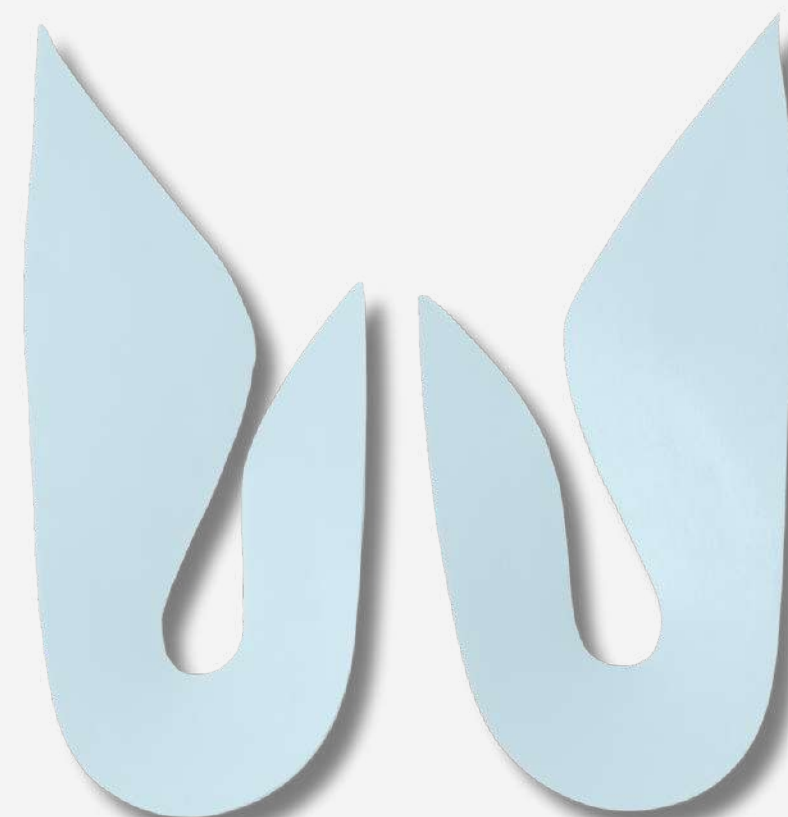



**Não fique com dúvidas,
contate o nosso Consultor
de Vendas!**

**Posso te
ajudar?**



**Clique aqui para
entrar em contato**

